


Egyszerű hőmérsékletmérés

a hűtlánc megbízható felügyeletéhez és az érzékeny termékekhez

ÚJ! Ingyenes szoftverletöltés a www.testo.com weblapról

A mért értékek rugalmas és helyszíntől független:

- megtekintése • elemzése • archiválása

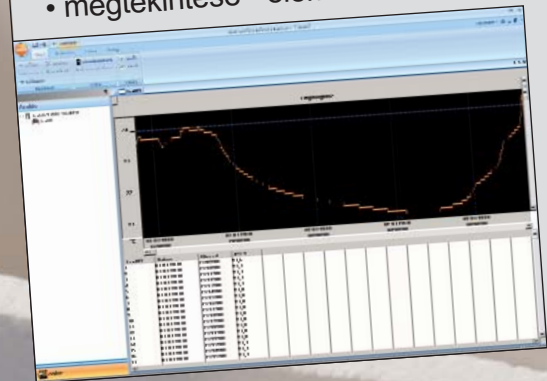

Hőmérsékletmérés a testo 174T mini adatgyűjtővel



Eredeti méret

- Adatbiztonság lemerült elemek esetén is
- Nagy adattároló
- Vízálló IP65
- Kompakt és robusztus
- Megfelel az EN12830 szabványnak
- Riasztás a kijelzőn
- Adatátvitel a PC-re USB interfésszel



testo 174T 1-csatornás mini adatgyűjtő, fali tartószerkezettel, elemekkel (2 x CR 2032 lítium) és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0572 1560



A testo 174T mini adatgyűjtő ideális a hőmérséklet mérésére hűtőszekrényekben, fagyasztószekrényekben, hűtőhelyiségekben és hűtőpolcokon.

testo 174T szett
testo 174T, 1 csatornás mini adatgyűjtő szett, USB interfésszel az adatgyűjtő programozásához és kiolvasásához, fali tartóval, elemmel (2 x CR 2032 lítium) és gyári műbizonylattal*

Rend. sz. 0572 0561




*Ingyenesen letölthető szoftver: www.testo.com, vagy rendelje meg a szoftvert külön CD-n.

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|---|
| Érzékelő típusa | Belső NTC hőmérséklet érzékelő |
| Méréstartomány | -30 ... +70 °C |
| Pontosság | ±0,5 °C (-30 ... +70 °C) |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -30 ... +70 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ... +70 °C |
| Telep típusa | 2 x 3 V gombelem (2 x CR 2032 lítium), felhasználó által cserélhető |
| Üzemidő | 500 nap (15 percenkénti mintavételezés, +25 °C-on) |
| Védelem | IP65 |
| Mintavételezés | 1 perc – 24 óra (választható) |
| Adattároló | 16.000 mért érték |
| Szoftver rendszerkövetelmény | Windows XP, Vista, Win7 |

Testo Kft. · 1139 Budapest · Rőppentyú utca 53.
· Telefon (06-1) 237-1747 · Telefax (06-1) 237-1748
· E-Mail: info@testo.hu · www.testo.hu

testo 174 adatgyűjtő szoftver

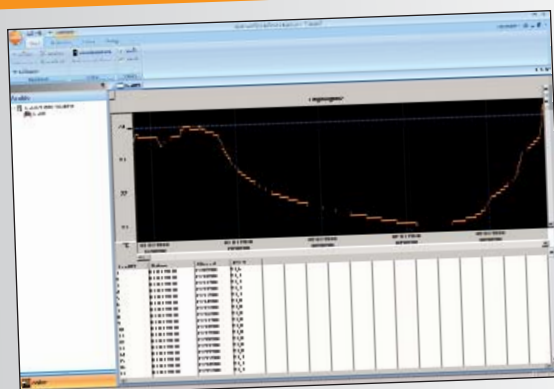

A testo 174 ComSoft szoftverrel az adatgyűjtő egyszerűen konfigurálható és kiolvasható USB interfésszel. A mért adatok gyorsan, intuitív módon elemezhetők.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
0981 3754/Std/XX/03.2010

Rendelhető tartozékok

| | Rend. sz. |
|---|--------------|
| USB interfész a testo 174T és testo 174H adatgyűjtő programozásához és kiolvasásához | 0572 0500 |
| testo 174 ComSoft CD (amennyiben nem kívánja igénybe venni az ingyenes, regisztrációhoz kötött internetes letöltést) | 0572 0580 |
| Lítium CR 2032 gombelem, kérjük adatgyűjtőként 2 elemet rendeljen | 0515 0028 |
| ISO kalibrálási bizonylat hőmérsékletre, 3 választható kalibrálási ponton, -30 ... +70°C méréstárományban, csatornánként/műszerenként | 28 0529 0002 |